


USB 接口温湿度记录器安装说明

注意：您所使用的记录器是 USB 接口，仅能使用标准 USB 电缆连接到计算机，否则可能造成接口的损坏！

安装步骤：

- 1、运行光盘中的 USB_Drivers.exe 程序（该程序在光盘内 usb_drivers 目录中），安装温度记录器的 USB 驱动。
- 2、安装完成后，温度记录器的 USB 驱动程序会在 windows 系统中仿真一个串口号，在 windows 系统的“设备管理器”中找到这个串口号（见下图），以备在运行温度记录管理软件时设置通讯端口时使用。

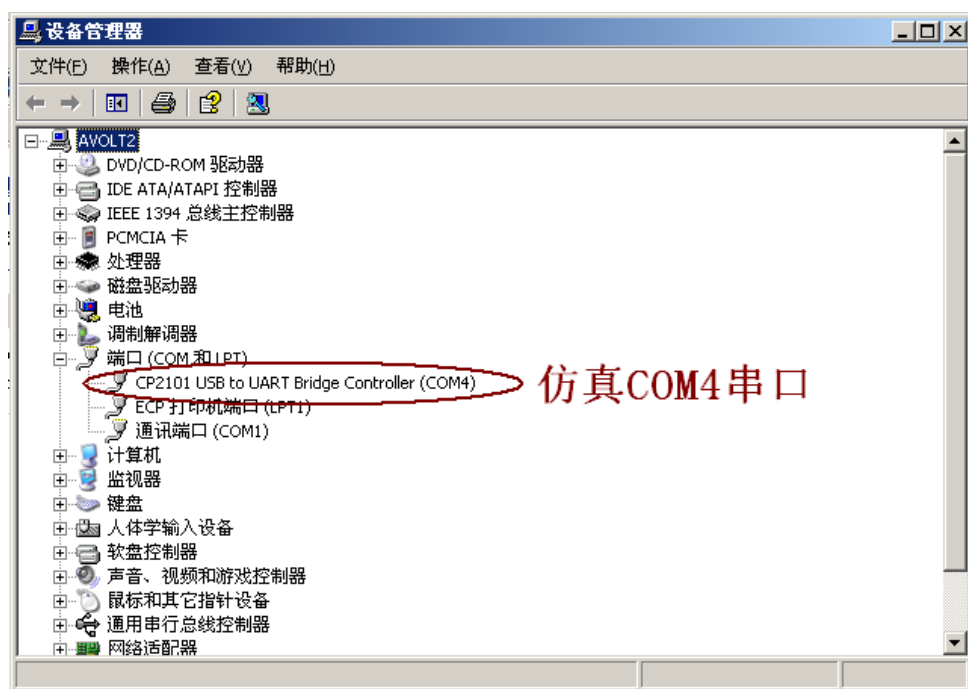

- 3、 安装温湿度记录管理软件，运行光盘内 setup.exe 程序。完成软件安装后，在 windows 的桌面上会生成“温湿度记录管理器”图标。
- 4、 使用随产品提供的标准 USB 电缆连接温度记录器到计算机，然后再运行温度记录管理器软件，进行记录器的设置。注意，在运行温度记录管理器软件之前，将记录器与计算机 USB 口连接好。
- 5、 在第一次运行温度记录管理器软件时，首先需要设置通讯端口和通讯波特率，选择菜单：通讯-配置通讯端口，进入通讯设置窗口，将通讯端口选择在第 2 步获得的 USB 驱动程序仿真的串口号（比如是 COM4 串口），波特率选择 57600Bps。设置界面见下图。



详细信息请与您的经销商联系。